

BIOMONCONI SIRONA®



PROTESI DIRETTA ALL'IMPIANTO

ROTATORI

	Codice	Altezza gengivale
4 mm	INPSIER1	1 mm
	INPSIER2	2 mm
	INPSIER3	3 mm

Vite: INTTUH

NON ROTATORI

	Codice	Altezza gengivale
4,5 mm	* INPSIE1	1 mm
	* INPSIE2	2 mm
	* INPSIE3	3 mm

* Queste parti sono vendute insieme alla loro viti INTTUHCR

ROTATORI

	Codice	Altezza gengivale
4 mm	INPSIUR1	1 mm
	INPSIUR2	2 mm
	INPSIUR3	3 mm

Vite: INTTUH

NON ROTATORI

	Codice	Altezza gengivale
4 mm	INPSIU1	1 mm
	INPSIU2	2 mm
	INPSIU3	3 mm

Vite: INTTUH

NON ROTATORI

	Codice	Altezza gengivale
4,5 mm	* INPSIUL1	1 mm
	* INPSIUL2	2 mm
	* INPSIUL3	3 mm

* Queste parti sono vendute insieme alla loro viti INTTUHCR

PROTESI SU TRANSEPITELIALE

UNIT®

	Codice	Altezza gengivale
4,5 mm	PSUPE	0,5 mm
		3,5

Vite: TTMIR

	Codice	Altezza gengivale
4 mm	PSUPU	0,5 mm
		4,1

Vite: TTMIR


	Codice	Altezza gengivale
4,5 mm	PSUPA	2 mm
		5,5

Vite: TTMUAPA

MULTI-IM®

	Codice	Altezza gengivale
4,5 mm	PSMIPU	2 mm
		4,1

Vite: TTMIR



Viti sono vendute separatamente

STEP by STEP

CAT-142 ITA - Bioplares Sirona V.05 - ABRIL 2021



Posizione di Scan Body su il Ti Base.



Visualizzazione virtuale del Scan Body dopo aver regolato (best fit) tra fisico e virtuale.



Scelta del lavoro da svolgere.




Selezione del Ti Base.




Opzioni di Ti Base, tra cui scegliamo SBL41.



Dettagli del caso completato.



Vista virtuale della scansione.

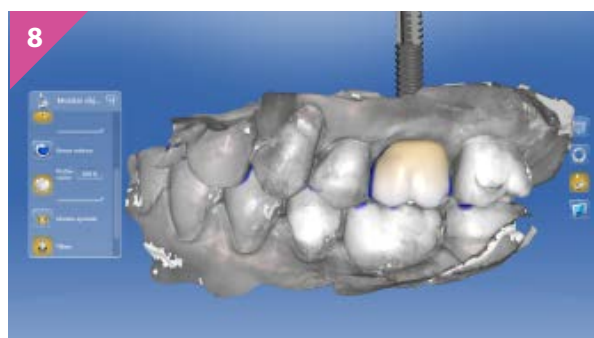

Visualizzazione virtuale del progetto definitivo.